

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 208 796 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
29.05.2002 Patentblatt 2002/22

(51) Int Cl.7: **A61B 6/00**

(21) Anmeldenummer: 00125227.9

(22) Anmeldetag: 22.11.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Erbel, Stephan**
81677 München (DE)

(74) Vertreter: **Schwabe - Sandmair - Marx**
Stuntzstrasse 16
81677 München (DE)

(71) Anmelder: **BrainLAB AG**
85551 Kirchheim/Heimstetten (DE)

(54) **Verfahren zur Bestimmung der Lungenfüllung**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Lungenfüllung, bei dem die Bewegung einer sich mit der Atmung bewegenden anatomischen Struktur bzw. eines oder mehrerer Punkte auf der sich bewegenden anatomischen Struktur, deren Bewegungsbahn mit dem Lungenfüllung hoch korreliert ist, gegenüber dem Ort mindestens einer atmungsortsfesten anatomischen Struktur erfasst wird, und bei dem dann jedem Abstand zwischen den Strukturen ein bestimmter Lungenfüllungswert zugeordnet wird. Ferner betrifft sie ein

Verfahren zur Unterstützung einer Bestrahlung bei atmungsbedingten Verschiebungen eines Bestrahlungsziels, bei dem mittels eines vorher genannten Verfahrens die Zuordnung der Lungenfüllwerte zu dem Abstand der sich bewegenden Struktur, welche bei einer Durchleuchtung, insbesondere auf einer Röntgenaufnahme erkennbar ist, und der atmungsortsfesten Struktur ermittelt wird, die aktuelle Bestrahlungszielposition auf der Basis des Lungenfüllungswerts erfasst wird, und bei dem die Bestrahlung mit Unterstützung durch die bekannte aktuelle Bestrahlungszielposition erfolgt.

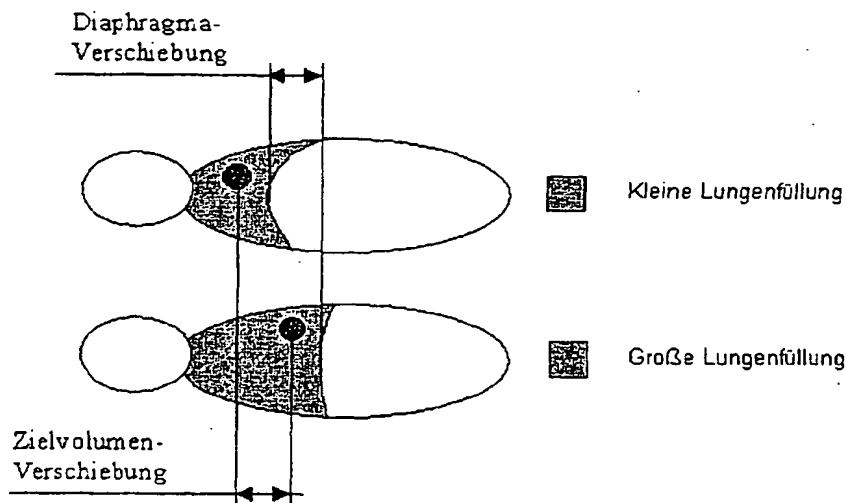


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der aktuellen Lungenfüllung gemäß dem Anspruch 1 und ein Verfahren zur Bestrahlungsunterstützung bei atmungsbedingten Verschiebungen eines Bestrahlungsziels gemäß dem Anspruch 8.

[0002] Das Bestrahlen von Tumoren in Bereich der Lunge, Leber und Nieren, wird maßgeblich dadurch erschwert, dass diese Bereiche eine atembedingte Verschiebung erfahren. Um diese Verschiebung zu erfassen beziehungsweise zu messen, gibt es derzeit nur unzulängliche Systeme. In der heutigen klinischen Anwendung werden die Patienten im CT oder in einem Durchleuchtungsbild "kartografiert", d. h. ein Planungsdatensatz wird erstellt, und ein Zielvolumen wird eingezeichnet und gegenüber einem Patientenkoordinatensystem lokalisiert (zum Beispiel mit Hautmarkierungen). Das Problem dabei ist jedoch, dass die Position der angesprochenen Zielvolumina von der Luftmenge beeinflusst wird, die der Patient während der Aufnahme des CTs in seinen Lungen hat. Die während der Planung festgestellte Position des Zielvolumens gilt also nur für genau eine Lungenfüllung. In der Figur 1 ist die Verschiebung des Zielvolumens bei Variieren der Lungenfüllung beim frei atmenden Patienten dargestellt.

[0003] Die Lungenfüllung des Patienten ist die Größe, welche die Position des Zielvolumens im Körper des Patienten beeinflusst. Verfolgt man die Lungenfüllung des Patienten über die Zeit, so stellt man fest, dass diese sich mit jedem Atemzug verändert (dies sind die etwa 0,5 Liter Luft, die der Patient ein- und ausatmet). Verfolgt man die Lungenfüllung jedoch über längere Zeit, so stellt man fest, dass sich das Maximum, das Minimum und die Mittellage der Atmung über die Zeit hin ebenfalls verändern, wie dies in Figur 2 dargestellt ist, welche die Variation der Lungenfüllung über die Zeit ersichtlich macht.

[0004] Es ist demnach für einen beliebig gewählten Zeitpunkt (bzw. kurzen Zeitraum) in der Zukunft nicht vorherzusagen wo sich das Maximum, das Minimum und die Mittellage der Lungenfüllung eines Patienten befinden werden.

[0005] Es besteht das Problem der mangelnden Übertragbarkeit eines 3D-Planungsdatensatzes auf den Zustand des Patienten zum Zeitpunkt der Bestrahlung. Wurde der Planungsdatensatz des Patienten bei angehaltener Atmung aufgenommen (im Normalfall ist dies das Planungs-CT), so stellt dieser Datensatz den Patienten und die Position des Zielvolumens bei einer bestimmten Lungenfüllung dar. Um diese Daten auf den Zustand des Patienten zum Zeitpunkt der Bestrahlung übertragen zu können müssten die Lungenfüllungen zu beiden Zeitpunkten genau übereinstimmen. Kann der Patient während der Bestrahlung frei atmen, so ist dies zu höchstens zwei Zeitpunkten pro Atemzug der Fall. Da Patienten, die für das Planungs-CT ihre Atmung für etwa 10 bis 20 Sekunden anhalten müssen, dazu nei-

gen, davor etwas stärker oder schwächer als bei normaler Atmung ein- oder auszuatmen, kann es auch vorkommen, dass der Patient während des Bestrahlungstermins zu keinem Zeitpunkt die gleiche Lungenfüllung wie auf dem Referenz-(Planungs-)Datensatz hat. In diesem Fall ist die Position des Zielvolumens zu keinem Zeitpunkt bekannt, eine punktgenaue Bestrahlung ist somit unmöglich.

[0006] Es wäre deshalb bei vielen medizinischen Anwendungen vorteilhaft, die Atmung des Patienten genau erfassen zu können, zum Beispiel um die Position von Organen oder Tumoren verfolgen zu können, welche durch die Atmung beeinflusst werden. Zu diesem Zweck wurden bereits Verfahren entwickelt, welche die Veränderung äußerer Parameter des Patienten erfassen, und es so erlauben die Atmung des Patienten zu erfassen. Auch durch Spirometrie lässt sich die Atmung des Patienten verfolgen. Problematisch bei diesen Lösungen ist jedoch, dass die Atmung nur verfolgt werden kann, solange der Patient mit dem System in Kontakt bleibt. Ist es jedoch notwendig die Atmung zu vergleichen, die der Patient zu zwei etwas weiter auseinanderliegenden Zeitpunkten hatte, so müssten die obengenannten Systeme permanent mit dem Patienten in Kontakt bleiben. Da dies bei vielen medizinischen Anwendungen nicht möglich oder unerwünscht ist, ist dieser ununterbrochene Kontakt in der Regel nicht gegeben. Bei allen bisher bekannten Verfahren stellt sich dadurch das Problem, dass es nicht möglich ist den Nullpunkt oder einen anderen absoluten Referenzpunkt mit zufriedenstellender Genauigkeit wiederzufinden. Messwerte, zwischen deren Akquisition die Messung unterbrochen wurde, sind somit nicht mehr direkt vergleichbar. Die Ursache für die nicht zufriedenstellende Genauigkeit ist zum Beispiel das Verrutschen von Hautfettsschichten und darauf aufgebrachtener Referenzmarkierungen, oder bei der Spirometrie die mangelnde Reproduzierbarkeit der maximalen und minimalen Lungenfüllung.

[0007] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Bestimmung der aktuellen Lungenfüllung und ein Verfahren zur Bestrahlungsunterstützung bei atmungsbedingten Verschiebungen eines Bestrahlungsziels bereitzustellen, welche die oben aufgezeigten Probleme lösen. Insbesondere soll die Bestrahlung von atmungsbedingt verschiebbaren Bestrahlungszielen optimiert werden.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß zunächst durch ein Verfahren zur Bestimmung der Lungenfüllung, bei dem die Bewegung einer sich mit der Atmung bewegendenden anatomischen Struktur bzw. eines oder mehrerer Punkte auf der sich bewegendenden anatomischen Struktur, deren Bewegungsbahn mit dem Lungenfüllung hoch korreliert ist, gegenüber dem Ort mindestens einer atmungsortsfesten anatomischen Struktur erfasst wird, und bei dem dann jedem Abstand zwischen den Strukturen ein bestimmter Lungenfüllungswert zugeordnet wird.

[0009] Die Erfindung löst also die oben genannten

Probleme dadurch, dass ein Parameter verwendet wird, welcher nicht durch das Verrutschen externer Referenzen verfälscht wird, die Atmung des Patienten eindeutig beschreibt und durch eine Messung mit vernünftigem Aufwand erfasst werden kann. Einen solchen Parameter liefert der oben beschriebene Abstand, woraus sich die Möglichkeit ergibt, die Atmung zu jedem Zeitpunkt genau zu verfolgen, d. h. die Lungenfüllung jederzeit und auch bei zeitlich auseinanderliegenden Erfassungen positiv zu bestimmen. Auf der Basis dieser Kenntnis können dann alle weiteren Erfassungen und Behandlungen umso genauer und in optimierter Weise durchgeführt werden.

[0010] Bei einer Ausführungsform der Erfindung wird die Erfassung durch Erstellung von Durchleuchtungsbildern, insbesondere Röntgenbildern durchgeführt, wobei vorzugsweise mindestens zwei Aufnahmen erstellt und die restlichen Werte für die Lungenfüllung interpoliert werden.

[0011] Ferner kann die Erfassung durch Erstellung von Bildern aus Schichtbildaufnahmeverfahren, zum Beispiel CT-, MR-, PET-Verfahren, durchgeführt werden, wobei vorzugsweise mindestens zwei Aufnahmen erstellt und die restlichen Werte für die Lungenfüllung interpoliert werden. Vorteilhafterweise werden dabei als Aufnahmen digital rekonstruierte Röntgenbilder verwendet, die aus einem Datensatz eines Schichtbildaufnahmeverfahrens erhalten werden.

[0012] Besonders vorteilhaft ist die Verwendung solcher Parameter, die zusätzlich zu den drei obigen Anforderungen (kein Verrutschen, eindeutige Beschreibung der Atmung des Patienten und Messung mit vernünftigem Aufwand) sowohl bei einer Durchleuchtung als auch in dreidimensionalen Planungsdatensätzen erfasst werden können. Erfindungsgemäß ist deshalb vorteilhafterweise die sich mit der Atmung bewegende anatomische Struktur eine bei einer Durchleuchtung, insbesondere auf einer Röntgenaufnahme erkennbare Struktur, bevorzugt das Lungendiaphragma bzw. ein Punkt auf dem Lungendiaphragma (Zwerchfell).

[0013] Es wird also ein charakteristischer Punkt einer Struktur der menschlichen Anatomie, welcher durch die Atmung mitbewegt wird und sowohl im Röntgenbild als auch in dreidimensionalen Planungssätzen sichtbar ist, betrachtet, zum Beispiel das Lungendiaphragma. Wird der Abstand zwischen dieser Referenz zu der atmungs-ortsfesten (also durch die Atmung nicht mitgeführten) anatomischen Struktur, zum Beispiel ein Wirbelkörper oder ein Wirbelkörperanteil, insbesondere eine Wirbelkörperkante, ermittelt und verfolgt, so erhält man einen Wert, welcher zur Lungenfüllung des Patienten sehr hoch korreliert ist.

[0014] Alternativ ist es ebenfalls möglich den scheinbaren Abstand zwischen den beiden Referenzen in einem zweidimensionalen Bild zu vermessen. Damit die Messwerte aus verschiedenen zweidimensionalen Abbildungen direkt verglichen werden können, ist es jedoch notwendig, dass die Projektionsparameter beider

Abbildungen identisch sind (Ansichtswinkel und Entfernung entsprechen einander bei digital rekonstruierten Röntgenbildern und echten Röntgenaufnahmen). Die Erfindung fasst demgemäß auch ins Auge, dass eine erste Erfassung durch Erstellung von Durchleuchtungsbildern, insbesondere Röntgenbildern durchgeführt wird, und eine zweite Erfassung durch Erstellung von entsprechenden Bildern aus Schichtbildaufnahmeverfahren, zum Beispiel CT-, MR-, PET-Verfahren, durchgeführt wird, wobei immer vorzugsweise mindestens zwei Aufnahmen erstellt und die restlichen Werte für die Lungenfüllung interpoliert werden, und wobei ein Vergleich bzw. Abgleich der bestimmten Lungenfüllungswerte erfolgt.

[0015] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Unterstützung einer Bestrahlung bei atmungsbedingten Verschiebungen eines Bestrahlungsziels, bei dem

- mittels eines oben beschriebenen Verfahrens die Zuordnung der Lungenfüllwerte zu dem Abstand der sich bewegenden Struktur, welche bei einer Durchleuchtung, insbesondere auf einer Röntgenaufnahme erkennbar ist, und der atmungsorts-festen Struktur ermittelt wird,
- die aktuelle Bestrahlungszielposition auf der Basis des Lungenfüllungswerts erfasst wird, und bei dem
- die Bestrahlung mit Unterstützung durch die bekannte aktuelle Bestrahlungszielposition erfolgt.

[0016] Mit anderen Worten umfasst dieses Verfahren also das Feststellen sowohl der Lungenfüllung, die der Patient während der Aufnahme eines oder mehrerer Planungsdatensätze hatte, als auch der Lungenfüllung, die der Patient während der Bestrahlung hat. Durch eine Verknüpfung der entsprechenden Informationen lässt sich dann mit der bekannten Lungenfüllung als Bindeglied mittels der Daten aus dem Planungsdatensatz (diese enthalten die Position des Bestrahlungsziels) und der Daten aus der aktuellen Durchleuchtung (diese enthalten meist nicht die Position des Behandlungsziels, insbesondere bei Röntgenaufnahmen, mit denen zum Beispiel ein Tumor oft nicht ausreichend sichtbar gemacht werden kann, aber sie enthalten die aktuelle Position von positionsverfolgbaren Trackingeinrichtungen, zum Beispiel Markierungen) auch die Position des Bestrahlungsziels bzw. dessen Bewegung ermitteln. Beide Datensätze enthalten nämlich den Abstand zwischen beweglicher und ortsfester Struktur, der auf die Lungenfüllung schließen lässt. Die Position des Zielvolumens wird insbesondere bei mehreren Lungenfüllungen bestimmt, so dass im Folgenden aus der Lungenfüllung die Position des Zielvolumens errechnet werden kann.

[0017] Bei einer Ausführungsvariante wird die aktuelle Bestrahlungszielposition auf der Basis des Lungenfüllungswerts dadurch erfasst, dass

- der Positionsverlauf eines Bestrahlungsziels bei der Erfassung der Bewegung der sich bewegenden Struktur mit erfasst wird und jedem Abstandswert, d. h. jedem Lungenfüllungswert ein Positionswert des Bestrahlungsziels zugeordnet wird,
- vor der Bestrahlung mindestens eine, vorzugsweise mindestens zwei Durchleuchtungen erfolgen, bei denen die Bewegung der sich bewegenden anatomischen Struktur gegenüber der Position einer positionsgebenden Trackingeinrichtung, insbesondere Markierung am Patienten erfasst wird und dann jedem Abstand zwischen der Struktur und den Markierungen ein bestimmter Lungenfüllungswert zugeordnet wird,
- aus den Zuordnungen von Bestrahlungszielposition zu Lungenfüllungswert und Lungenfüllungswert zur Positionsinformation der Trackingeinrichtung, insbesondere Markierungsposition eine Abhängigkeit der aktuellen Bestrahlungszielposition von der Positionsinformation der Trackingeinrichtung, insbesondere der Markierungsposition ermittelt wird.

[0018] Die Zuordnung der Lungenfüllwerte zu dem Abstand der sich bewegenden Struktur und der atmungsortsfesten Struktur kann mittels digital aus einem Schichtbildaufnahmedatensatz rekonstruierter Röntgenbilder (DRRs) ermittelt werden, welche in Winkellage und Aufnahmeentfernung den Durchleuchtungen vor oder bei der Bestrahlung entsprechen.

[0019] Die aktuelle Bestrahlungszielposition kann in Echtzeit oder zeitversetzt auf der Basis des Lungenfüllungswerts erfasst werden.

[0020] Die Positionsinformation der Trackingeinrichtung kann erhalten werden durch Auswertung der Daten mindestens einer der folgenden Einrichtungen bzw. Verfahren, die atembeflussende Parameter liefern:

- Markierungen, insbesondere reflektierende Markeranordnungen, vorzugsweise für Infrarotlicht, die mittels eines computergestützten Trackingsystems positionell im Raum erfasst und verfolgt werden können,
- Konturüberwachung des Patienten durch Videokameras, zum Beispiel durch Interferenzmuster oder mittels polarisiertem Licht,
- Dehnungsmessbänder,
- Spirometrie,
- Elektromyographie,
- mechanisches Abtasten eines oder mehrerer Punkte auf der Patientenoberfläche, insbesondere mittels einer Koordinatenmessmaschine.

[0021] Die Kenntnis der aktuellen Bestrahlungszielposition kann zur Steuerung des Ein- und Ausschaltens des Therapiestrahls verwendet und insbesondere dazu genutzt werden, den Therapiestahl nur dann einzuschalten, wenn das Bestrahlungsziel innerhalb eines wählbaren Toleranzbereiches um das Bestrahlungsziel

bzw. die Bestrahlungsachse eines Therapiegerätes liegt. Ferner oder zusätzlich kann diese Kenntnis der aktuellen Bestrahlungszielposition, also auch des kopfnähesten und fußnähesten Punktes, dazu genutzt werden, einen der Endpunkte von deren Bewegungsbahn, relativ zum Zielpunkt oder der Zielachse eines Therapiegerätes, so zu positionieren, dass bei atemgesteuerter Bestrahlung eine optimal hohe anteilige Bestrahlungszeit erreicht wird. Nach dem Ausatmen bleibt das Bestrahlungsziel bzw. das Zielvolumen für fast eine Sekunde lang unbewegt. Aus diesem Grund ist es besonders sinnvoll das Zielvolumen zu diesem Zeitpunkt zu bestrahlen, da man eine akzeptable anteilige Bestrahlungszeit bei minimaler residueller Bewegung des Zielvolumens erhält

[0022] Außerdem ist es möglich, die Kenntnis der aktuellen Bestrahlungszielposition dazu zu nutzen, eine dynamische Repositionierung während der Bestrahlung vorzunehmen, um mittelfristige Schwankungen der Randwerte, nämlich Minimum und Maximum, der Lungenfüllung des Patienten zu berücksichtigen. Hat der Patient während der Atmung zum Beispiel zunehmend weniger Luft in seiner Lunge, so verschiebt sich die Mittellage des Zielvolumens im Patienten; ebenso verschieben sich die beiden Extrempunkte der momentanen Bewegungsbahn. Dies kann dazu führen, dass das Zielvolumen den Zielpunkt/die Zielachse des Bestrahlungsgerätes nicht mehr durchquert, bzw. dass das Zielvolumen den Zielpunkt/die Zielachse des Bestrahlungsgerätes zu schnell durchquert. Dies kann durch ein entsprechendes Verschieben des Patienten relativ zum Bestrahlungsgerät ausgeglichen werden.

[0023] Die Bewegung des Bestrahlungsziels innerhalb des Patienten kann durch ein kontinuierliches, gegenläufiges Bewegen des Patienten auf einer Patientenliege ausgeglichen werden. Ferner kann der Patient durch künstliche Zwangsbeatmung, in einen Zustand gebracht werden, in dem der Lungenfüllungswert dem Wert entspricht, der bei der Zuordnung der Lungenfüllwerte zu dem Abstand der sich bewegenden Struktur der atmungsortsfesten Struktur, also insbesondere im Planungsstadium mit Schichtbildaufnahmen, ermittelt wurde.

[0024] Eine Ausführungsform der Erfindung wird im Weiteren erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 die Verschiebung des Zielvolumens bei Variieren der Lungenfüllung beim frei atmenden Patienten;

Figur 2 die Variation der Lungenfüllung über die Zeit;
Figur 3 eine schematische Darstellung der Berechnung eines digital rekonstruierten Röntgenbildes (DRR);

Figur 4 eine Gegenüberstellung eines DRR und eines entsprechenden Röntgenbildes;

Figur 5 ein Durchleuchtungsbild, in dem das Bestrahlungsziel, und der Abstand zwischen dem Lungendiaphragma und einem charak-

- teristischen, atmungsortsfesten Skelettpunkt bezeichnet sind;
- Figur 6 Lungenfüllung und Tumorposition in zwei verschiedenen Atmungszuständen;
- Figur 7 die Position des Bestrahlungsziels (Zielvolumen), in einem Diagramm aufgetragen über der Position des Lungendiaphragmas (Lungenfüllung);
- Figur 8 die Position von Markern, in einem Diagramm aufgetragen über der Position des Lungendiaphragmas (Lungenfüllung); und
- Figur 9 den diagrammatischen Rückschluss von der Position der Marker auf die Position des Bestrahlungsziels (Zielvolumen).

[0025] Die Ausführungsform der Erfindung wird im folgenden mittels einer chronologischen Darstellung der Vorgehensweise erläutert.

[0026] Anfangs erfolgt eine Aufnahme der Planungsdatensätze. Im Gegensatz zur konventionellen Vorgehensweise wird der Patient nicht nur einmal gescannt, sondern mindestens zweimal. Als bildgebende Verfahren kommen dabei alle Schichtbildverfahren in Frage (MR, CT, PET, ...). Notwendig ist hierbei, dass die Aufnahmen bei angehaltener Atmung angefertigt werden, und dass sich die Lungenfüllung bei den verschiedenen Aufnahmen unterscheidet (vorzugsweise ein Scan nach dem Einatmen, ein Scan nach dem Ausatmen). In beiden Datensätzen wird auf herkömmliche Weise das Zielgebiet definiert.

[0027] Bei jedem Bestrahlungstermin werden dem Patienten ein oder mehrere Marker auf den Thorax geklebt, die sich mit der Atmung des Patienten verschieben. Die Position dieser Marker wird in Echtzeit über ein computer- und kameraunterstütztes Trackingsystem verfolgt. Über einen Atemzyklus verteilt werden nun vom Patienten mindestens zwei Röntgenaufnahmen gemacht (zum Beispiel mit Röntgenquellen an der Raumdecke; das Bild wird von einem digitalen Detektor unter dem Patienten aufgenommen). Der Ansichtswinkel aus dem die Röntgenbilder aufgenommen wurden, muss dabei bekannt sein; die Position der Marker auf dem Thorax des Patienten zum Zeitpunkt der Bildaufnahme wird abgespeichert.

[0028] Durch entsprechende geometrische Berechnungen lässt sich aus den 3D-Planungsdatensätzen jeweils ein "Digital Rekonstruiertes Röntgenbild" (DRR) errechnen, das zu dem Ansichtswinkel passt, aus dem die Röntgenaufnahmen gemacht wurden. In der Figur 3 ist schematisch dargestellt, wie ein solches Bild errechnet wird, das auch die Positionsinformationen des Bestrahlungsziels enthält. Eine Gegenüberstellung von DRR (links) und entsprechender Röntgenaufnahme des Thorax ist in Figur 4 zu sehen.

[0029] Der Bildbereich für die Röntgenaufnahmen und die DRRs wird so gewählt, dass auf dem Bild das Lungendiaphragma zu erkennen ist. (Das Lungendiaphragma ist sozusagen die Grenze zwischen der Lunge

und der darunter liegenden Leber.) Aufgrund des hohen Dichteunterschiedes zwischen Leber und Lunge ist diese Trennlinie sowohl in den DRRs als auch in den Röntgenbildern zu erkennen. Die Position des Lungendiaphragmas im Brustkorb des Patienten definiert die Lungenfüllung des Patienten zu dem jeweiligen Zeitpunkt.

[0030] In den vorliegenden Bildern lässt sich, wie beispielhaft in Figur 5 gezeigt, demnach von Hand oder automatisiert das Diaphragma einzeichnen. Wird in jedem Bild der Abstand zwischen einem charakteristischen Punkt der sich nicht mit der Atmung verschiebt (dies kann zum Beispiel eine Kontur eines Wirbelkörpers oder eine Rippe sein) und eines Punktes auf dem Diaphragma gemessen, so lässt sich dem entsprechenden Bild ein Wert zuordnen, der die Lungenfüllung des Patienten eindeutig beschreibt. Der auf diese Weise gemessene Wert soll im folgenden als "Lungenfüllungswert" bezeichnet werden. Die Figur 6 zeigt schematisch den Abstand zwischen dem Diaphragma und einem charakteristischen Punkt des Skeletts bei zwei verschiedenen Atmungszuständen auf (Zustände I und II).

[0031] Die so erzeugten Daten werden nun paarweise in Relation zueinander gesetzt und man erhält eine Beziehung zwischen der Tumorposition und dem Lungenfüllungswert (Diaphragmaposition). Hier ist anzumerken, dass die zur besseren Verständlichkeit vereinfachten Abbildungen die Vorgehensweise lediglich für eine Raumkoordinate (Kopf-Fuß-Richtung) zeigen. Die Position des Tumors muss jedoch in allen drei Raumkoordinaten bestimmt werden, und die Korrelationen für alle Achsen bestimmt werden.

[0032] In den Planungsdatensätzen ist sowohl die Position des Zielvolumens, als auch der zu dieser Position des Zielvolumens passende Lungenfüllungswert abzulesen. Es lässt sich demnach eine Interpolationsgerade durch diese Wertepaare legen, welche den Zusammenhang zwischen beiden Größen beschreibt. Dies ist in der Figur 7 gezeigt, in welcher die Position des Zielvolumens aufgetragen ist über der Position des Diaphragmas (Lungenfüllungswert); die Interpolationskurve ist eingezeichnet, und sie kann gut linear angenähert werden.

[0033] Analog ist bei den Röntgenbildern jeweils die Position der (IR-reflektierenden) Marker und der dazu passende Lungenfüllungswert bekannt. Durch diese Wertepaare lässt sich nun ebenfalls eine Interpolationsgerade legen, die den Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen beschreibt. Die Figur 8, welche Position der Marker auf dem Thorax aufgetragen über die Lungenfüllung zeigt, enthält auch diese zweite Interpolationslinie.

[0034] Mathematisch lassen sich diese beiden Interpolationsfunktionen so verknüpfen, dass sie anhand der Position der reflektierenden Marker auf die Position des Zielvolumens schließen lassen. Graphisch ist dieser Rückschluss von der Position der Marker auf die Position des Zielvolumens in der Figur 9 dargestellt. Hier sind die beiden Diagramme aus den Figuren 7 und 8 auf

der linken Seite übereinander gestellt. Die fette Linie zeigt die Vorgehensweise an. Zunächst wird im unteren Diagramm aus der Markerposition der Lungenfüllungswert ermittelt. Mit dieser Information geht man in das obere Diagramm und erhält zum ermittelten Lungenfüllungswert die Position des Zielvolumens.

[0035] Dies bedeutet nun aber, dass, wenn die Position der Marker in Echtzeit verfolgt wird, sich auch die Position des Zielvolumens in Echtzeit errechnen lässt. Anhand der in Echtzeit bekannten Position des Zielvolumens lässt sich nun die atemgesteuerte Bestrahlung des Patienten mit sehr hoher Genauigkeit durchführen.

[0036] Gegenüber der direkten Erfassung der Position der aufgeklebten Marker hat das erfindungsgemäße Verfahren einen großen Vorteil, der in der Genauigkeit und Zuverlässigkeit liegt. Dies liegt daran, dass die Positionstreue der Marker durch das Verrutschen auf den Fettschichten nicht optimal ausreichend ist, wenn der Patient zwischen der Erfassung des Planungsdatensatzes und der eigentlichen Bestrahlung bewegt wird. Dies wird aber immer der Fall sein, wenn er vom CT in den Bestrahlungsraum gebracht werden muss.

[0037] Marker können nur solange zuverlässig in Referenz gesetzt werden, wie ein Patient ruhig liegen bleibt. Sobald er aufsteht bzw. die Marker abgenommen werden ist die Zuordnung ungenau. Ein direktes Zuordnen von Tumorposition und Markerposition ist deshalb nicht optimal. Eine erfindungsgemäße Zuordnung Tumor-Diaphragma im CT und eine noch "warme" Zuordnung Diaphragmapositions-Marker am Linearbeschleuniger, bei der das Verfahren zur Bestimmung der Lungenfüllung gemäß der vorliegenden Erfindung eingesetzt wird, löst diese Probleme.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung der Lungenfüllung, bei dem die Bewegung einer sich mit der Atmung bewegenden anatomischen Struktur bzw. eines oder mehrerer Punkte auf der sich bewegenden anatomischen Struktur, deren Bewegungsbahn mit dem Lungenfüllung hoch korreliert ist, gegenüber dem Ort mindestens einer atmungsortsfesten anatomischen Struktur erfasst wird, und bei dem dann jedem Abstand zwischen den Strukturen ein bestimmter Lungenfüllungswert zugeordnet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Erfassung durch Erstellung von Durchleuchtungsbildern, insbesondere Röntgenbildern durchgeführt wird, wobei vorzugsweise mindestens zwei Aufnahmen erstellt und die restlichen Werte für die Lungenfüllung interpoliert werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Erfassung durch Erstellung von Bildern aus Schichtbildaufnahmeverfahren, zum Beispiel CT-, MR-,

PET-Verfahren, durchgeführt wird, wobei vorzugsweise mindestens zwei Aufnahmen erstellt und die restlichen Werte für die Lungenfüllung interpoliert werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem als Aufnahmen digital rekonstruierte Röntgenbilder verwendet werden, die aus einem Datensatz eines Schichtbildaufnahmeverfahrens erhalten werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die sich mit der Atmung bewegende anatomische Struktur eine bei einer Durchleuchtung, insbesondere auf einer Röntgenaufnahme erkennbare Struktur ist, bevorzugt das Lungendiaphragma bzw. ein Punkt auf dem Lungendiaphragma.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die atmungsortsfeste anatomische Struktur ein Wirbelkörper oder ein Wirbelkörperteil, insbesondere eine Wirbelkörperkante ist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem eine erste Erfassung durch Erstellung von Durchleuchtungsbildern, insbesondere Röntgenbildern durchgeführt wird, und bei dem eine zweite Erfassung durch Erstellung von entsprechenden Bildern aus Schichtbildaufnahmeverfahren, zum Beispiel CT-, MR-, PET-Verfahren, durchgeführt wird, wobei immer vorzugsweise mindestens zwei Aufnahmen erstellt und die restlichen Werte für die Lungenfüllung interpoliert werden, und bei dem ein Vergleich bzw. Abgleich der bestimmten Lungenfüllungswerte erfolgt.
8. Verfahren zur Unterstützung einer Bestrahlung bei atmungsbedingten Verschiebungen eines Bestrahlungsziels, bei dem
 - mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7 die Zuordnung der Lungenfüllwerte zu dem Abstand der sich bewegenden Struktur, welche bei einer Durchleuchtung, insbesondere auf einer Röntgenaufnahme erkennbar ist, und der atmungsortsfesten Struktur ermittelt wird,
 - die aktuelle Bestrahlungszielposition auf der Basis des Lungenfüllungswerts erfasst wird, und bei dem
 - die Bestrahlung mit Unterstützung durch die bekannte aktuelle Bestrahlungszielposition erfolgt.
9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem die aktuelle Bestrahlungszielposition auf der Basis des Lungenfüllungswerts dadurch erfasst wird, dass
 - der Positionsverlauf eines Bestrahlungsziels

bei der Erfassung der Bewegung der sich bewegenden Struktur mit erfasst wird und jedem Abstandswert, d. h. jedem Lungenfüllungswert ein Positionswert des Bestrahlungsziels zugeordnet wird,

- vor der Bestrahlung mindestens eine, vorzugsweise mindestens zwei Durchleuchtungen erfolgen, bei denen die Bewegung der sich bewegenden anatomischen Struktur gegenüber der Position einer positionsgebenden Trackingeinrichtung, insbesondere Markierung am Patienten erfasst wird, und bei dem dann jedem Abstand zwischen der Struktur und den Markierungen ein bestimmter Lungenfüllungswert zugeordnet wird,
- aus den Zuordnungen von Bestrahlungszielposition zu Lungenfüllungswert und Lungenfüllungswert zur Positionsinformation der Trackingeinrichtung, insbesondere Markierungsposition eine Abhängigkeit der aktuellen Bestrahlungszielposition von der Positionsinformation der Trackingeinrichtung, insbesondere der Markierungsposition ermittelt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem die Zuordnung der Lungenfüllwerte zu dem Abstand der sich bewegenden Struktur und der atmungsorfsfesten Struktur mittels digital aus einem Schichtbildaufnahmedatensatz rekonstruierter Röntgenbilder (DRRs) ermittelt wird, welche in Winkellage und Aufnahmeentfernung den Durchleuchtungen vor der Bestrahlung entsprechen.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei dem die aktuelle Bestrahlungszielposition in Echtzeit oder zeitversetzt auf der Basis des Lungenfüllungswerts erfasst wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, bei dem die Positionsinformation der Trackingeinrichtung erhalten wird durch Auswertung der Daten mindestens einer der folgenden Einrichtungen bzw. Verfahren, die atembeflinusste Parameter liefern:

- Markierungen, insbesondere reflektierende Markeranordnungen, vorzugsweise für Infrarotlicht, die mittels eines computergestützten Trackingsystems positionell im Raum erfasst und verfolgt werden können,
- Konturüberwachung des Patienten durch Videokameras, zum Beispiel durch Interferenzmuster oder mittels polarisiertem Licht,
- Dehnungsmessbänder,
- Spirometrie,
- Elektromyographie,
- mechanisches Abtasten eines oder mehrerer Punkte auf der Patientenoberfläche, insbesondere mittels einer Koordinatenmessmaschine.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, bei dem die Kenntnis der aktuellen Bestrahlungszielposition zur Steuerung des Ein- und Ausschalten des Therapiestrahls verwendet und insbesondere dazu genutzt wird, den Therapiestrahls nur dann einzuschalten, wenn das Bestrahlungsziel innerhalb eines wählbaren Toleranzbereiches um das Bestrahlungsziel bzw. die Bestrahlungsachse eines Therapiegerätes liegt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13, bei dem die Kenntnis der aktuellen Bestrahlungszielposition, also auch des kopfnähesten und fußnähesten Punktes, dazu genutzt wird, einen der Endpunkte von deren Bewegungsbahn, relativ zum Zielpunkt oder der Zielachse eines Therapiegerätes, so zu positionieren, dass bei atemgesteuerter Bestrahlung eine optimal hohe anteilige Bestrahlungszeit erreicht wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, bei dem die Kenntnis der aktuellen Bestrahlungszielposition dazu genutzt wird, eine dynamische Repositionierung während der Bestrahlung vorzunehmen, um mittelfristige Schwankungen der Randwerte, nämlich Minimum und Maximum, der Lungenfüllung des Patienten zu berücksichtigen.

16. Verfahren nach Anspruch 15, bei dem die Bewegung des Bestrahlungsziels innerhalb des Patienten durch ein kontinuierliches, gegenläufiges Bewegen des Patienten auf einer Patientenliege ausgeglichen wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, bei dem der Patient durch künstliche Zwangsbeatmung, in einen Zustand gebracht wird, in dem der Lungenfüllungswert dem Wert entspricht, der bei der Zuordnung der Lungenfüllwerte zu dem Abstand der sich bewegenden Struktur der atmungsorfsfesten Struktur, also insbesondere im Planungsstadium mit Schichtbildaufnahmen ermittelt wurde.

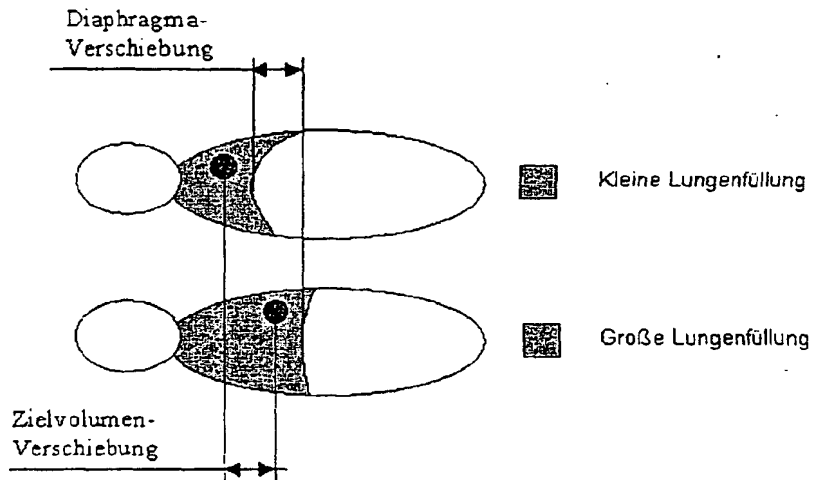


Fig. 1

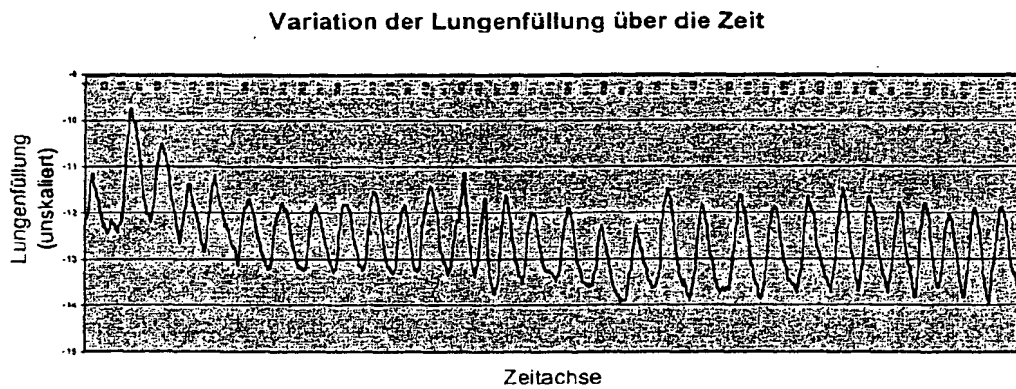


Fig. 2

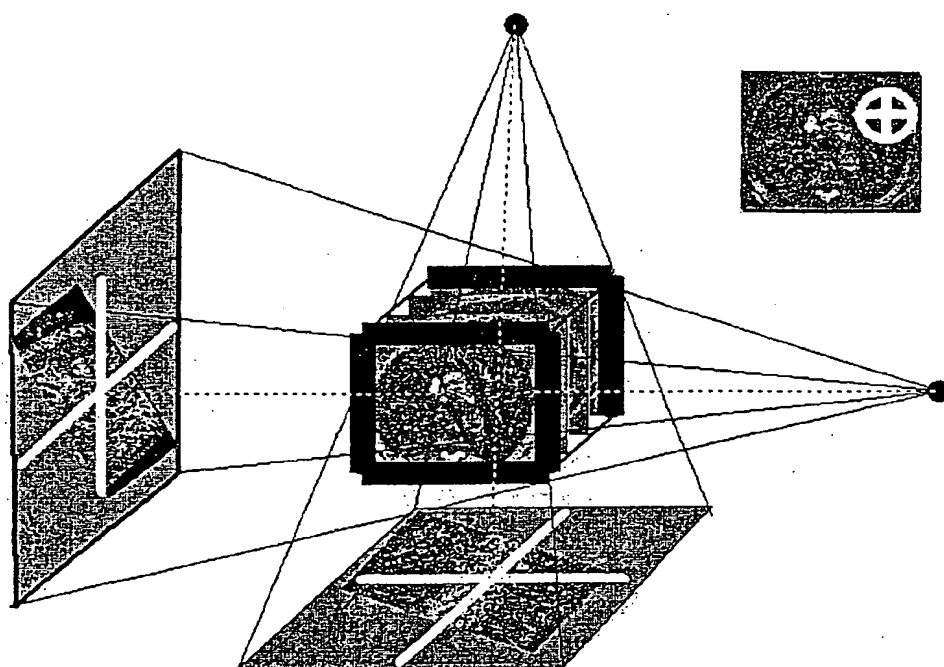


Fig. 3

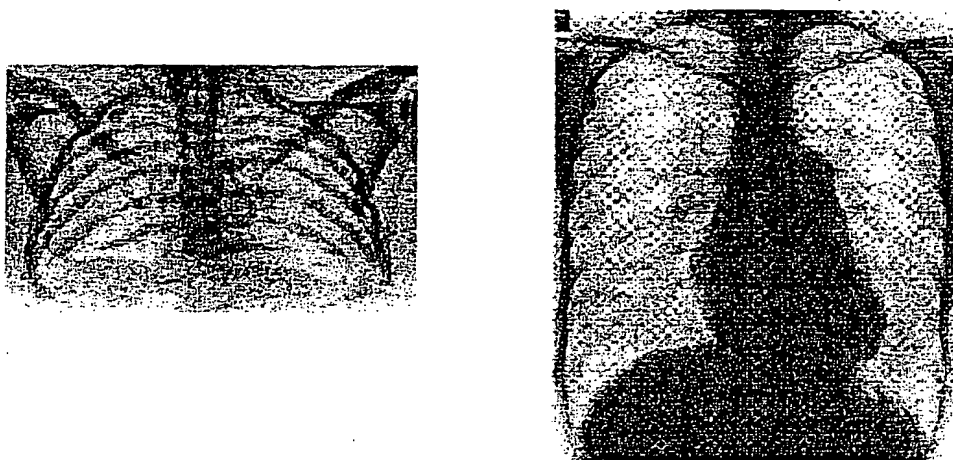


Fig. 4

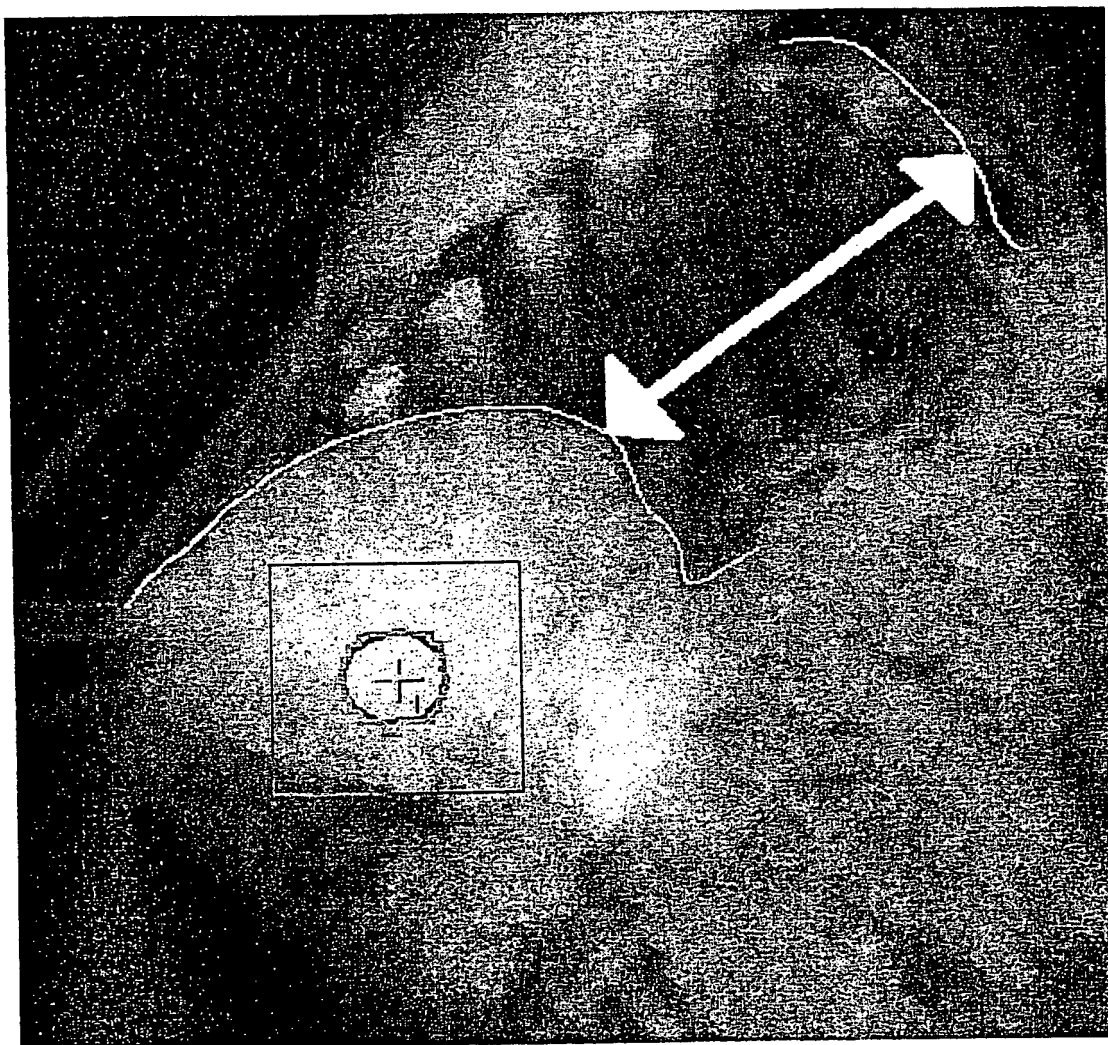


Fig. 5

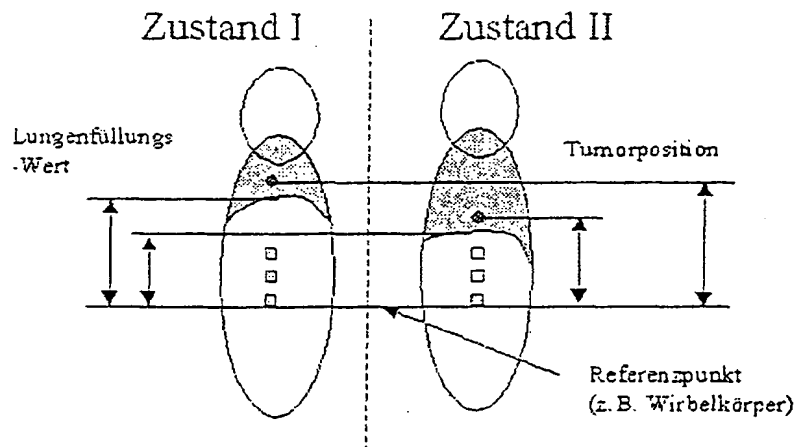


Fig. 6

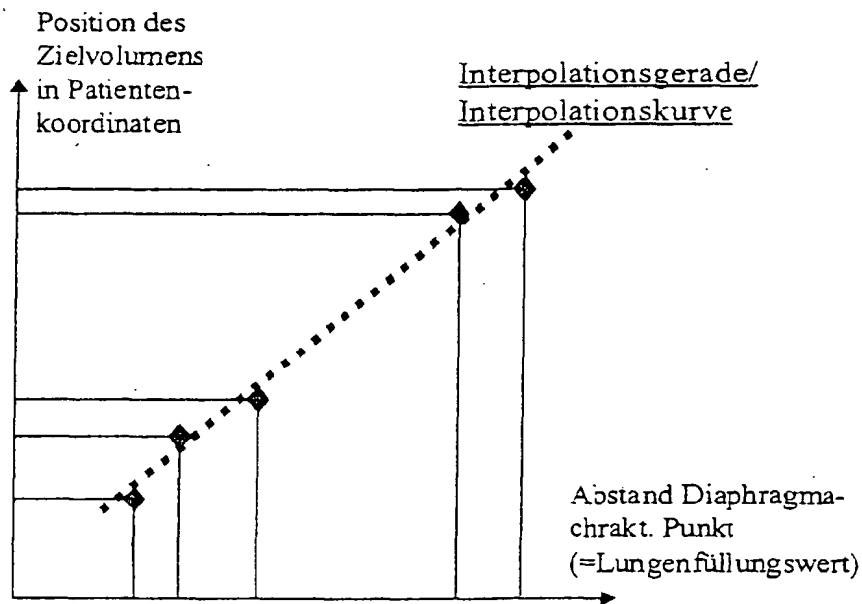


Fig. 7

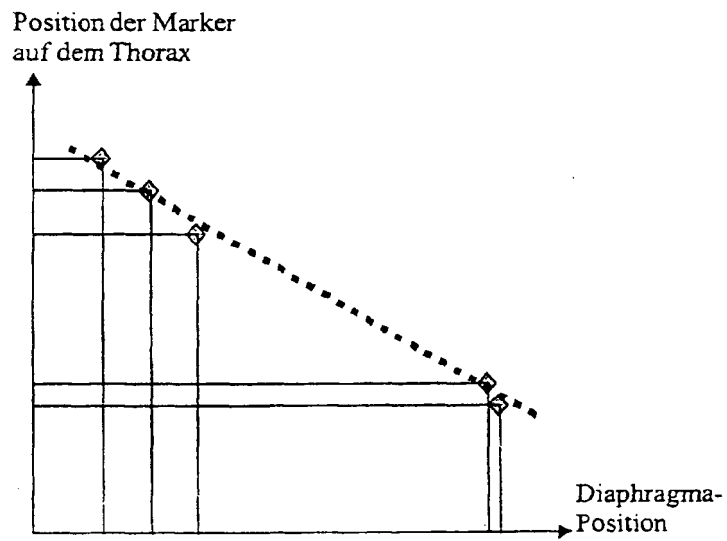


Fig. 8

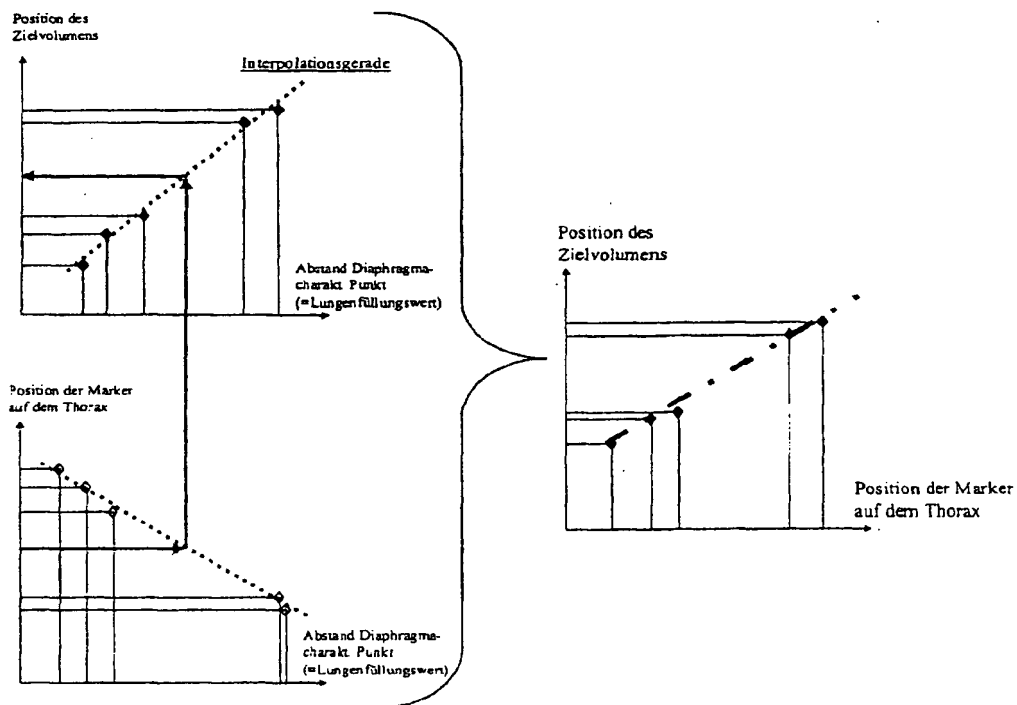


Fig. 9



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-
übereinkommens für das weitere Verfahren als
europäischer Recherchenbericht gilt

Nummer der Anmeldung

EP 00 12 5227

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 5 588 439 A (HOLLUB SETH D) 31. Dezember 1996 (1996-12-31) * Spalte 2, Zeile 30 - Zeile 57 *	1	A61B6/00
X	US 5 287 276 A (CRAWFORD CARL R ET AL) 15. Februar 1994 (1994-02-15) * Spalte 5, Zeile 19 - Zeile 45; Abbildung 5 *	1	
A	KUBO H D ET AL: "RESPIRATION GATED RADIOTHERAPY TREATMENT: A TECHNICAL STUDY" PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY, 68, TAYLOR AND FRANCIS LTD. LONDON, Bd. 41, Nr. 1, 1996, Seiten 83-91, XP000548771 ISSN: 0031-9155 * Seite 85, Absatz 2.2 * * Seite 86, Absatz 3.2 * * Seite 90, Absatz 5 *	1-7	
A	US 5 538 494 A (MATSUDA KOJI) 23. Juli 1996 (1996-07-23) * Spalte 5, Zeile 6 - Zeile 52 *	1-7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			A61B
UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE			
<p>Die Recherchenabteilung ist der Auffassung, daß ein oder mehrere Ansprüche, den Vorschriften des EPU in einem solchen Umfang nicht entspricht bzw. entsprechen, daß sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik für diese Ansprüche nicht, bzw. nur teilweise, möglich sind</p> <p>Vollständig recherchierte Patentansprüche:</p> <p>1-7</p> <p>Unvollständig recherchierte Patentansprüche:</p> <p>8-17</p> <p>Nicht recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Grund für die Beschränkung der Recherche:</p> <p>Artikel 52 (4) EPÜ - Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers</p>			
Forschungsort		Abschlußdatum der Recherche	
DEN HAAG		4. Mai 2001	
Prüfer		Manschet, J	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : nichtschriftliche Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>8 : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER
TEILRECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 12 5227

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	
A	DE 198 29 224 A (BRAINLAB MED COMPUTERSYST GMBH) 5. Januar 2000 (2000-01-05) * das ganze Dokument *	1-7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)

EPO FORM 1503 03 82 (P/C12)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 12 5227

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

04-05-2001

im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5588439	A	31-12-1996	KEINE		
US 5287276	A	15-02-1994	US	5251128 A	05-10-1993
			DE	4137652 A	21-05-1992
			GB	2250164 A, B	27-05-1992
			JP	4332538 A	19-11-1992
US 5538494	A	23-07-1996	JP	2921433 B	19-07-1999
			JP	7303710 A	21-11-1995
DE 19829224	A	05-01-2000	KEINE		

EPC FORM P2461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts. Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)